

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Kupujúci :	Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
So sídlom :	Hlinkova 3, 040 01 Košice
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000345190/8180, 7000345473/8180, 7000345481/818
IČO:	00 586 951
Tel.:	055 6334455
Fax:	055 6331414
E-mail:	petko@saske.sk

Ďalej len *Kupujúci*

1.2. Predávajúci :	BIOTECH s.r.o.
So sídlom :	Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava
Zastúpený :	RNDr.Petr Kvapil
Oprávnení rokovať :	
Vo veciach zmluvných :	RNDr.Petr Kvapil
Vo veciach technických :	Mgr.Miloš Čebík
Bankové spojenie :	ČSOB Bratislava
Číslo účtu :	802152823/7500
IČO :	35768444
DIČ :	2020221797
IČ DPH :	SK2020221797
Tel:	02/54774488
Fax:	02/54774488
E-mail :	biotech@biotech.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sro, vo vložke číslo: 19240/B

Ďalej len *Predávajúci*

Článok I. Predmet plnenia zmluvy

Predmetom plnenia Kúpnej zmluvy je dodanie „Zariadení na PCR a inkubátorov“ podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy

Článok II. Cena za predmet plnenia zmluvy

Cena za predmet plnenia Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Navrhovaná cena bez DPH v EUR je **168 033,61**

Navrhovaná cena s DPH v EUR je **201 640,33**

Výška 20% DPH je **33 606,72 EUR**



Článok III.
Termín dodania predmetu plnenia zmluvy

Predmet plnenia Kúpnej zmluvy dodá zhotoviteľ objednávateľovi na miesto: Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice najneskôr do 12 týždňov od podpisu Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Článok IV.
Platobné podmienky a fakturácia

Úhrada za poskytnutie kompletného predmetu plnenia Kúpnej zmluvy sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa na základe doručenej faktúry, súčasťou ktorej bude objednávateľom potvrdený odovzdávací protokol po dodávke jednotlivých tovarov. Zmluvné strany sa dohodli na **lehote splatnosti faktúr min. 90 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Vlastnícke právo predávaného Tvaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením ceny Tvaru podľa článku II. tejto zmluvy, vrátane DPH.

Riziká na Tvaroch prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho okamžikom protokolárneho prevzatia Tvaru do prevádzky zástupcom Kupujúceho.

Článok V.
Zodpovednosť za vady

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu protokolárneho odovzdania Tvaru do prevádzky Kupujúceho. Až do uplynutia tejto lehoty Predávajúci preberá zodpovednosť za všetky vady spôsobené výrobcom.

Pre opravené časti Tvaru platí šesťmesačná záručná doba a podmienky záruky ako pre pôvodne dodaný Tvar. U ostatných častí Tvaru sa záručná doba predlžuje iba o dobu, počas ktorej tieto časti Tvaru museli byť mimo prevádzky v dôsledku odstraňovania vady. Pokiaľ sa strany nedohodli inak, končí záručná doba vždy najskôr 12 mesiacov od dátumu protokolárneho odovzdania Tvaru do prevádzky Kupujúceho.

Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúceho všetky vady Tvaru. Vady Tvaru, ktoré môžu spôsobiť škodu je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúceho okamžite s následným písomným potvrdením. Písomné oznámenie vady Tvaru musí obsahovať popis vady.

Po doručení oznámenia vady Tvaru podľa článku V. je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 2 pracovných dní a na svoje náklady tieto vady Tvaru odstrániť. Vadné časti Tvaru, ktoré boli vymenené zostávajú majetkom Predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebovanie Tvaru pri jeho obvyklom použití, ďalej na vady Tvaru spôsobené neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej osoby, a vady Tvaru u ktorých sa nedá dokázať, že vznikli použitím vadného materiálu, chybnou konštrukciou alebo neúplným spracovaním, hlavne vady Tvaru vzniknuté chybnou údržbou, nedodržaním návodu k použitiu, jeho preťažovaním alebo nadmerným namáhaním, použitím nevhodných prevádzkových prostriedkov, atmosférickou elektrinou, chemickými a elektrolytickými vplyvmi a ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní pozáručného servisu predávajúcim. Pozáručný servis sa zaväzuje Predávajúci poskytnúť v prípade písomného oznámenia vady Kupujúcim – po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby.



Článok VI.
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu uhradiť v prípade omeškania s dodávkou Tvaru zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného Tvaru za každý kalendárny deň omeškania spôsobeného predávajúcim, maximálne však 7% z hodnoty nedodaného Tvaru.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu v prípade omeškania s úhradou faktúry úroky z omeškania, ktorých výška je určená nariadením vlády č.586/2008 Z.z. vo výške o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Kupujúci i Predávajúci sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy dlhšie ako 60 dní a omeškanie Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny dlhšie ako 60 dní po splatnosti faktúry. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pričom zmluva zaniká od počiatku a strany sú povinné si vrátiť všetko, čo si doteraz na jej základe plnili.

V prípade, že Kupujúci resp. Predávajúci odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa uhradiť preukázateľné náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu resp. Kupujúcemu z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

Článok VII.
Ďalšie zmluvné podmienky

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy č.023/2009/2.1/OPVaV, č.039/2009/2.2/OPVaV, č.012/2009/2.1/OPVaV, č.028/2009/2.1/OPVaV [ITMS kód: 26220120022, 26220220018, 26220120002, 26220120008], a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, resp. auditom overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste. Predávajúci sa súčasne zaväzuje zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v platnom znení, 513/1991 Zb. - Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi predpismi. Zmeny a doplnky zmluvy (pokiaľ tieto nevyplyvajú priamo z platných právnych predpisov) je možné vykonať na základe dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, poradovo očíslovaných.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

N. R. R.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich jednaní za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá zo spomenutých zmien týka, túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci dostane 4 výtlačky, predávajúci dostane 2 výtlačky.

Všetky strany tejto zmluvy sú parafované oboma stranami.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou číslovaných dodatkov.


Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola napísaná na základe pravdivých údajov, ich dobrej a slobodnej vôle a nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov / zákon o slobode informácií / v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Bratislava 27. 7. 2011

Kupujúci:



B. Petko

.....
Doc. MVDr. Branislav Petko, CSc.
riaditeľ

Bratislava 27. 7. 2011

Predávajúci :

BIOTECH s.r.o.
Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava
tel./fax: 02/ 54 77 44 88
ICO/35 768 444 IČ pre DPH: SK2020221797

.....
RNDr. Petr Kvapil
konateľ

B. Petko

Real-Time PCR + HRM systém CFX96 Biorad

- Kapacita 96 vzoriek
- otvorený systém pre platy - možnosť využívania stripov resp. 96 jamkovej platničky od rôznych výrobcov
- Objem vzorky: 5- 50 μ l
- Teplotný rozsah: 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy
- Možnosť nastavenia teplotného gradientu v rozsahu teplôt 30 - 100°C
- Teplotný rozsah gradientu 1 – 24°C
- Software: Absolútna kvantifikácia, $\Delta\Delta$ Ct, Allele-specific, Genotyping-End point, Melt curves,
- Software pre aplikáciu HRM (high resolution melting)
- Filtre - päť nezávislých optických kanálov
- Detekcia pomocou 6 filtrovaných fotodiód
- Fluorescenčné reagenty: SYBR green, FAM, HEX, ROX, Cy5, TAMRA
- Excitačné rozmedzie (450 – 684 nm)
- „Protocol autowriter“ – umožňuje navrhnúť optimálny protokol
- Rýchlosť zmeny teploty (chladenie) : 2-2.5°C/ sekunda
- Rýchlosť zmeny teploty (ohrev) : 5°C/ sekunda
- Teplotná presnosť $\pm 0,2^\circ\text{C}$ pri teplote bloku 90°C
- „Stand alone mode“ – možnosť priebehu Real-Time PCR aj bez použitia riadiaceho počítača
- Rýchle servisné zabezpečenie na Slovensku
- Licencia pre PCR a real-time PCR



Termocyklér MyCycler Biorad - 6 ks

- Kapacita vzoriek : 96 jamkový na 0,2 ml skúmavky, stripy alebo platničky
- Veľký 12 cm displej s možnosťou sledovania prebiehajúceho programu
- Teplotné rozhranie: 4-100°C
- Rýchlosť zmeny teploty : 2,5 °C/sek
- Pamäť: 99 programov
- Intuitívne ovládanie
- Pripojenie: USB



Ponuka


Termocyklér gradientový – C1000 48/48 Biorad - 3ks

- Termocyklér s dvoma nezávislými blokmi
- Celková vzorková kapacita 2x48 vzoriek
- Možnosť použitia samostatných skúmaviek, stripov alebo platničiek s kapacitou 0,2ml
- Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C
- Termálny gradient nezávislý pre oba bloky
- Gradientové teplotné rozpätie: 30-100°C
- Vymeniteľné bloky s možnosťou upgradovať na real-time PCR
- Teplotná presnosť: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, teplotná uniformita: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
- Nastaviteľná výška veka
- Rýchlosť zmeny teploty : 3-4 $^{\circ}\text{C}/\text{sek}$
- Pamäť: 1000 programov
- USB port s možnosťou ovládania prístroja cez počítač alebo USB



Horizontálna elektroforéza - Wide Mini-Sub Cell GT Systém Biorad

- Veľkosť gélu od 12,8 x 15 cm
- UV transparentná nalievacia platnička
- 2 ks hrebeňov
- Farebné stripy a necirkulačný port
- Zdroj napätia od 300 V

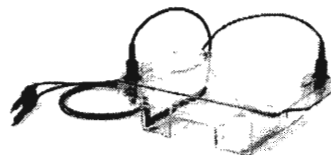

Termocyklér gradientový – C1000 48/48 Biorad - 1ks


- Termocyklér s dvoma nezávislými blokmi
- Celková vzorková kapacita 2x48 vzoriek
- Možnosť použitia samostatných skúmaviek, stripov alebo platničiek s kapacitou 0,2ml
- Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C
- Termálny gradient nezávislý pre oba bloky
- Gradientové teplotné rozpätie: 30-100°C
- Vymeniteľné bloky s možnosťou upgradovať na real-time PCR
- Teplotná presnosť: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, teplotná uniformita: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
- Nastaviteľná výška veka
- Rýchlosť zmeny teploty : 3-4 $^{\circ}\text{C}/\text{sek}$
- Pamäť: 1000 programov
- USB port s možnosťou ovládania prístroja cez počítač alebo USB



Ponuka

Horizontálna elektroforéza - Wide Mini-Sub Cell GT Systém Biorad

- Veľkosť gélu od 12,8 x 15 cm
- UV transparentná nalievacia platnička
- 2 ks hrebeňov
- Farebné stripy a necirkulačný port
- Zdroj napätia od 300 V

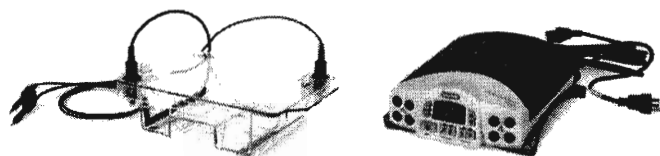

Termomixer TS-100C Biosan

- Rýchlosť v rozsahu 250-1400 RPM
- Teplota nastaviteľná 15°C pod RT až do +100°C
- Možný rozsah nastavenia from +4°C to +100°C (0.1°C)
- Časovač
- adaptér na 96x0,2 ml. Skúmavky
- vymeniteľné bloky – veľký výber



Suchý termostat TDB-120 Biosan


- Teplotný rozsah RT +120°C
- Teplotná stabilita 0.1°C
- blok pre skúmavky 21 x 0.5 ml + 32 x 1.5 ml + 50 x 0.2 ml
- kryt bloku na skúmavky
- časovač



Ponuka


Termostat BD53 Binder - 2 ks

- mikroprocesorové riadenie teploty
- elektronická ochrana proti prehriatiu s optickým a akustickým alarmom
- časovač 0 – 99 hod
- LED displej
- vnútorný povrch z nerezovej ocele
- ventilačný otvor s nastaviteľnou záklopkou
- použiteľný objem 53 litrov
- vnútorné rozmery 400x400x330 mm (šxvxh)
- 2 police v základnej výbave
- rozsah pracovnej teploty: RT +5 °C až 100 °C
- kolísanie teploty časové: < ± 0,1 °C pri 37°C
- RS422 interface
- 230V/50 Hz

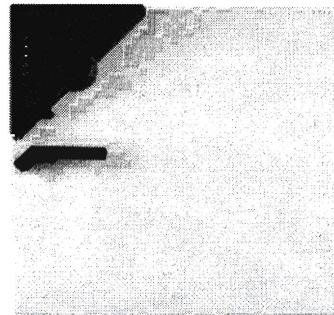

Termostat KB115 Binder – 6 ks


- Tepelný rozsah nastaviteľný od -10°C do 100°C
- Vnútorný objem 110 l
- Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej.
- Časový rozsah: od 1 min do 100 hod bez prerušenia,
- Integrovaný týždňový program
- Nútená cirkulácia vzduchu
- Vnútorné dvere: sklenené
- S vnútorným osvetlením komory
- Vnútorný priestor nerezový
- Varovný systém proti prehriatiu komory s automatickým vypnutím prístroja
- Dvojplášťový s priamym ohrevom v stenách prístroja
- S policami: 3 ks

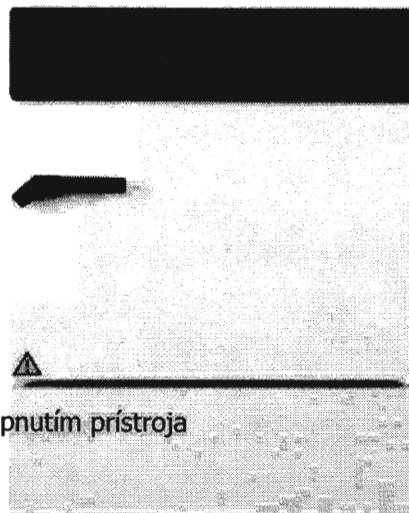

Ponuka


CO₂ inkubátor CB150 Binder – 1 ks

- APT Line mikroprocesorové multifunkčné riadenie teploty, chladenia, vlhkosti a obsahu CO₂
- multifunkčný digitálny LED displej
- teplotná ochrana podľa DIN 12880
- použiteľný objem 150 lit
- 3 police v základnej výbave
- rozsah pracovnej teploty: 7°C nad teplotu okolia až 60 °C
- kolísanie teploty priestorové: $\pm 0,3\%$
- kolísanie teploty časové: $\pm 0,1$ °C
- max. vlhkosť: 96 % rH
- čas návratu k pôvodným podmienkam po 30 s. otvorení dverí: 6 min
- rozsah nastavenia obsahu CO₂: 0-20 %
- presnosť nastavenia obsahu CO₂: 0,1°C
- infračervený senzor CO₂
- horúcovzdušná sterilizácia pre 180°C
- 220V/50Hz/260W

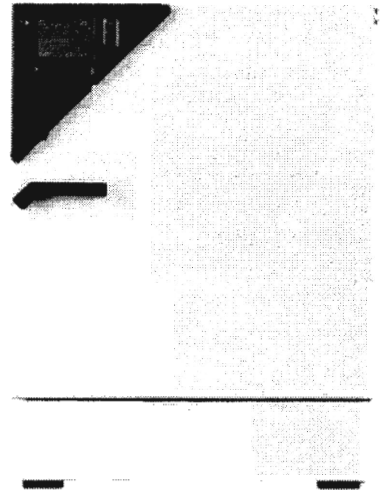

Inkubátor KB53 Binder - 1 ks

- Objem 53 litrov
- Vonkajšie rozmery: V(837 mm) x Hĺbka (634 mm) x Š (576 mm)
- ROZSAH Teplôt: -10 do + 100°C
- Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Mikroprocesorová regulácia a Digitálny displej.
- Časovač: 1min – 100 h, možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia (delayed ON/OFF)
- Bezpečnostný termostat.
- Vnútorne osvetlenie s automatickým zapínaním pri otvorení dverí.
- Nerezový interiér.
- Nútená cirkulácia vzduchu
- Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavov (napr. pri nezatvorených dverách).
- Možnosť pripojenia RS 232.

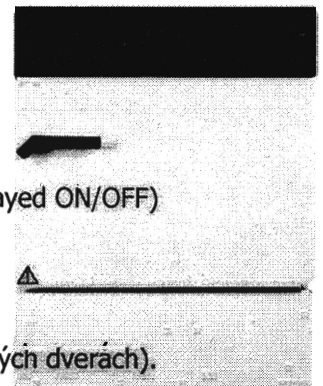


Handwritten signature or initials in blue ink.

Ponuka


Termoblok MC-01N Major Science - 1 ks

- Digitálne ovládaný termoblok s vymeniteľným blokmi pre prácu s platničkami aj mikroskúmvkami rôzneho objemu (1.5, 0.5 a 0,2 ml)
- Možnosť použitia ako mini-kúpeľ
- Rozsah teplôt od -10°C do 100°C, nastaviteľnosť po 0.1 °C
- LCD displej
- Časovač od 1 min do 15 hodín
- Možnosť pripojenia na PC
- Príslušenstvo : Bloky pre mikrotitračné platničky, 96 jamkové platničky, zmiešaný dvojblok pre 1.5 ml, 0.5 ml a 0.2 ml




Termostat vzdušný BD53 Binder - 1 ks

- mikroprocesorové riadenie teploty
- elektronická ochrana proti prehriatiu s optickým a akustickým alarmom
- časovač 0 – 99 hod
- LED displej
- vnútorný povrch z nerezovej ocele
- ventilačný otvor s nastaviteľnou zátkou
- použiteľný objem 53 litrov
- vnútorné rozmery 400x400x330 mm (šxvxh)
- 2 police v základnej výbave
- rozsah pracovnej teploty: RT +5 °C až 100 °C
- kolísanie teploty časové: < ± 0,1 °C pri 37°C
- RS422 interface
- 230V/50 Hz

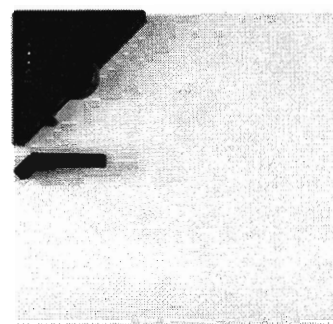

Termostat s riadenou atmosférou KB53 Binder - 1 ks

- Objem 53 litrov
- Rozsah teplôt: -10 do + 100°C
- Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní: ± 0.1°C
- Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej.
- Časovač: 1min – 100 h, možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia (delayed ON/OFF)
- Bezpečnostný termostat.
- Vnútorné osvetlenie s automatickým zapínaním pri otvorení dverí.
- Nerezový interiér.
- Nútená cirkulácia vzduchu
- Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavov (napr. pri nezatvorených dverách).
- Možnosť pripojenia RS 232.

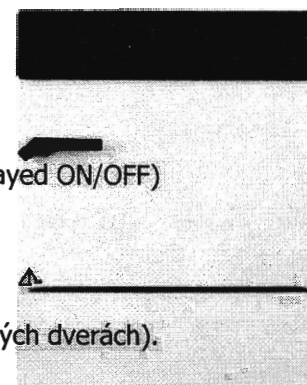

Ponuka

Inkubátor KB53 Binder - 1 ks

- Objem 53 litrov
- Rozsah teplôt: -10 do + 100°C
- Výchylka nastavenej teploty pri zohrievaní: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Mikroprocesorová regulácia a digitálny displej.
- Časovač: 1min – 100 h, možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia (delayed ON/OFF)
- Bezpečnostný termostat.
- Vnútorne osvetlenie s automatickým zapínaním pri otvorení dverí.
- Nerezový interiér.
- Nútená cirkulácia vzduchu
- Možnosť nastavenia alarmu neštandardných stavov (napr. pri nezatvorených dverách).
- Možnosť pripojenia RS 232.

